


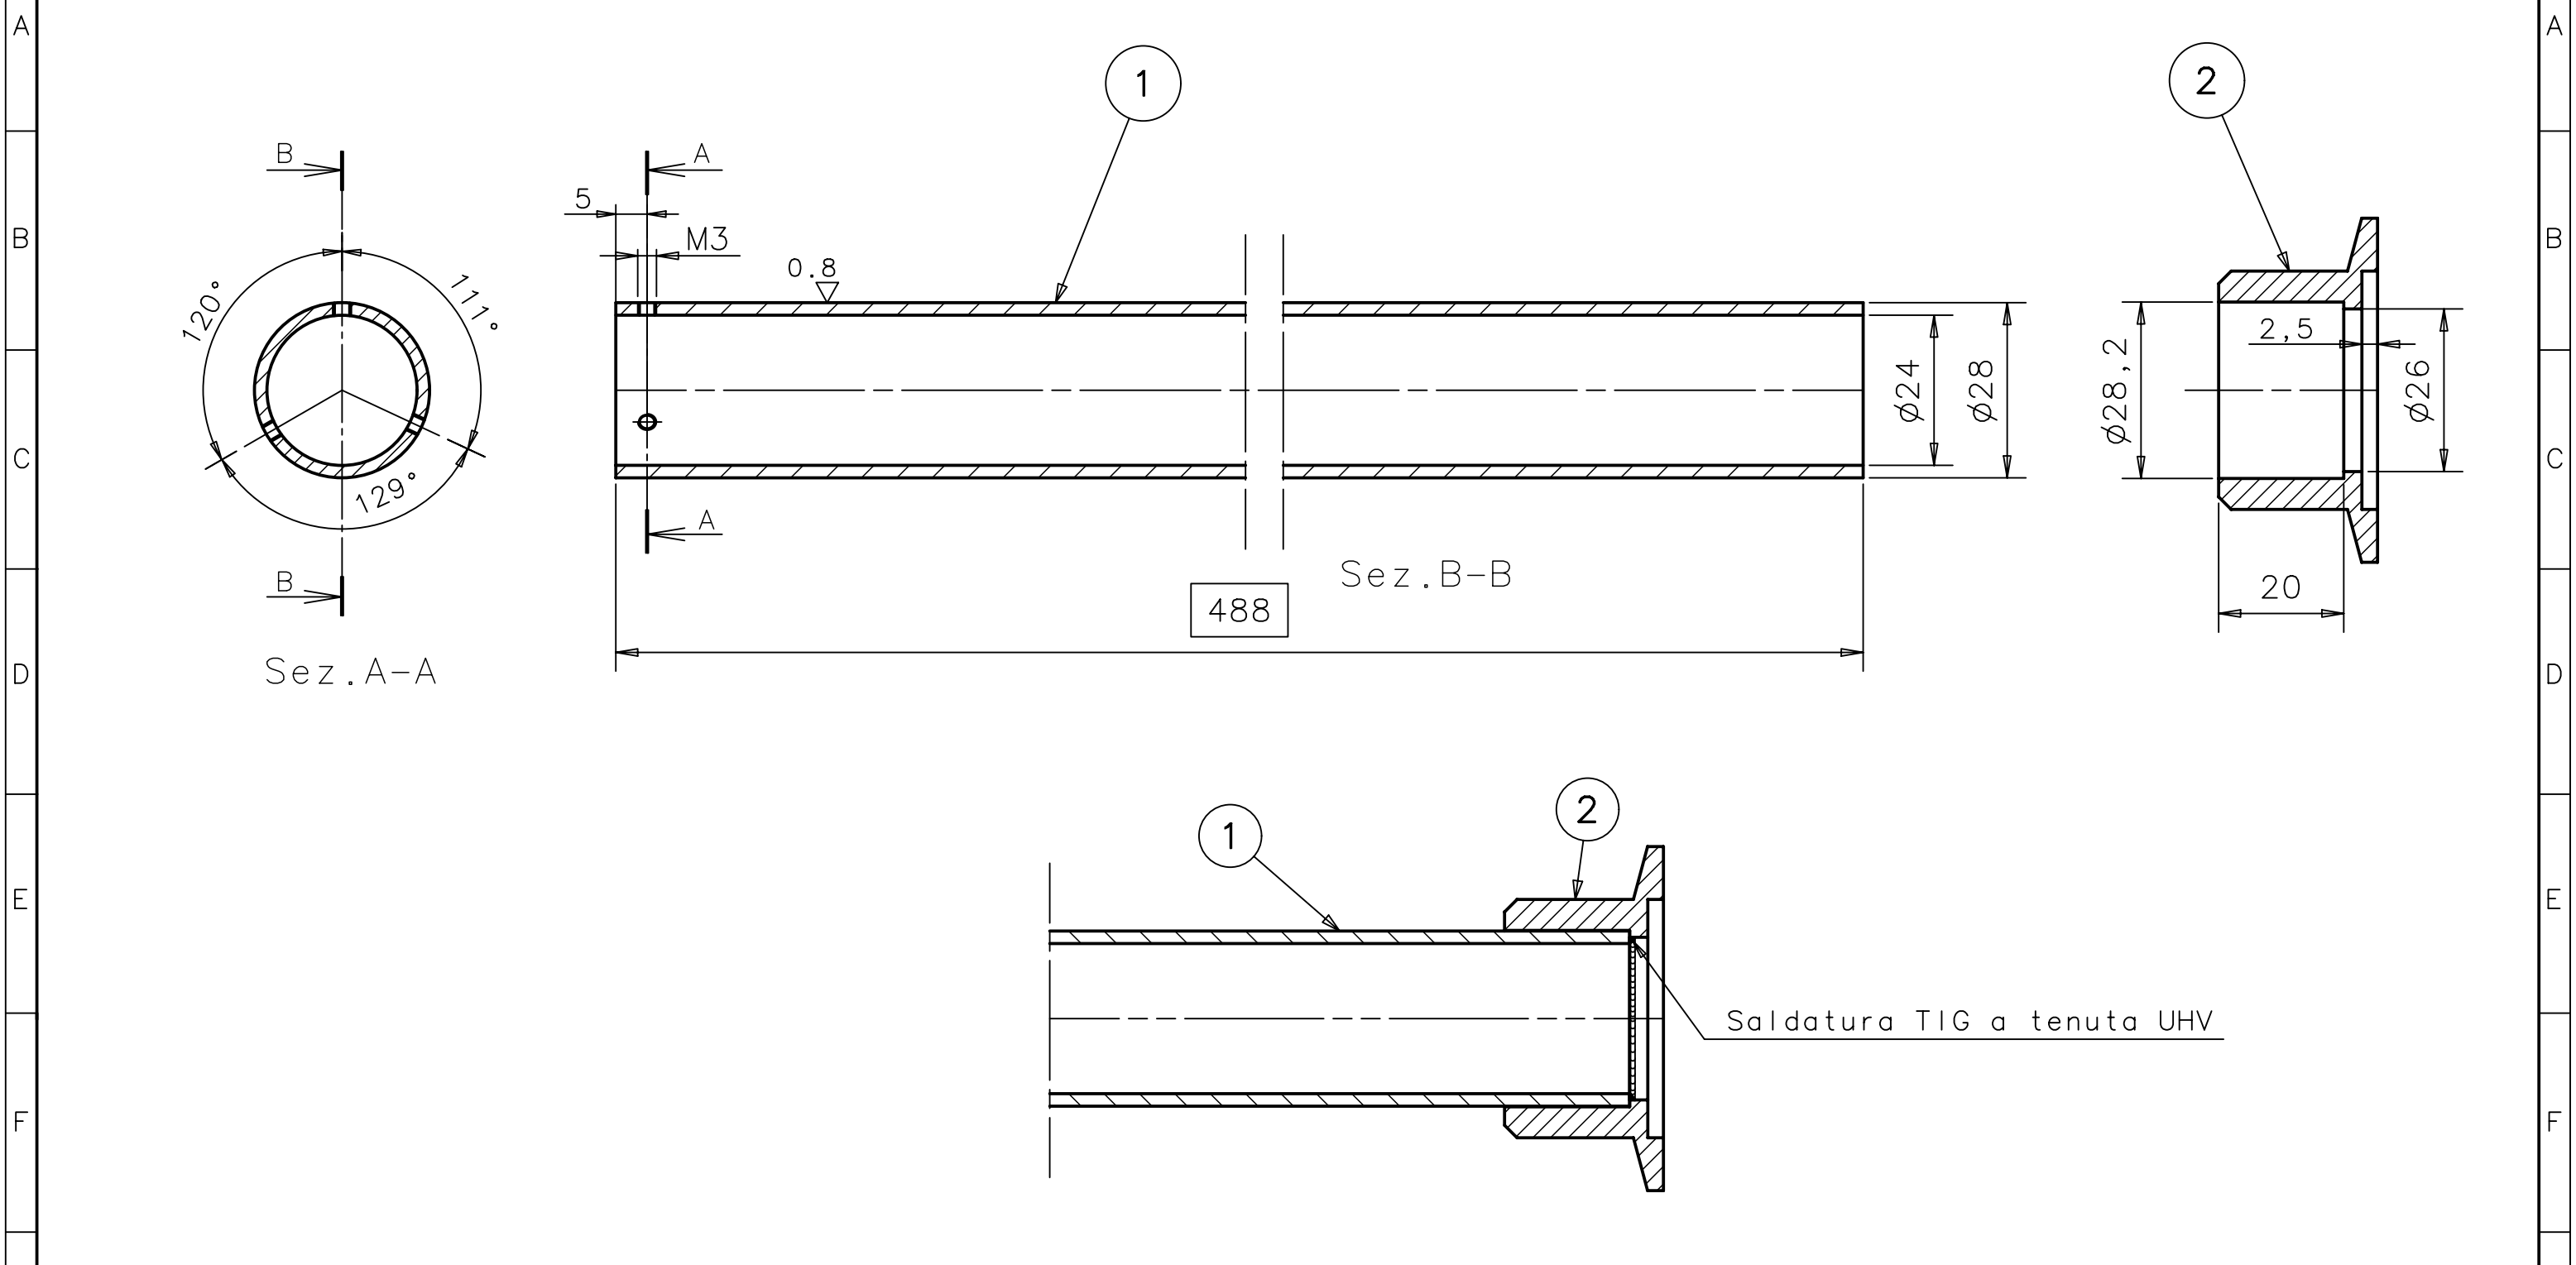

G	3						Approvato	Gadani	Smussi non quotati	Quote senza indicaz. di tolleranza	Scala
	2	Tappo DN40KF modificato	ved. Caburn MDC part. K150-US pag. 47	1	Comm.	Acciaio AISI 316	Controllato	Gadani	0,25x45°	ISO 2768 m K	1:1
	1	Tubo $\phi e=28$ $\phi i=24$ $l=518$		1		Acciaio AISI 316	Disegnato	Gadani	Rugosità R_a in μm	Tratt. termico e/o superf.	
	Pos.	Descrizione		N. Pezzi	Dis.	Materiale	Data Emissione	29/08/2003	3.2/	lucidatura	
H	C						 CONSORZIO RFX Ricerca Formazione Innovazione Corso Stati Uniti, 4 - 35127 Padova ITALY Tel. 049/8295000 - Fax 049/8700718			TITOLO - ESPERIMENTO MST strumentazione - Tomografia SXR - Secondo sistema di inserzione testa - Tubo $\phi e=28$ $\phi i=24$ $l=518$ e modifica al tappo DN40KF	
	B										
	A	--	--/--/--	--	--						
	Rev.	Descrizione		Data	Disegnato	Controllato	Dis. N°			H020046	FOGLIO 1/1
SOSTITUITO DAL DIS. -----		SOSTITUISCE IL DIS. -----									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12